



CÂMARA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA
ESTADO DE MINAS GERAIS

GABINETE DO CARRIJO

* ALTO Santiago, 289, APTO 704, TIBERY, 38.405-148, UBERLÂNDIA - MG

ASSUNTOS DIVERSOS Nº 17696/2019

Aprovado em: 04-06-2019

Of. Nº: _____/2024

Endereço:

Data: ____/____/____

Presidente Atual: Ver.  Wilmar Resende

Excelentíssimo Senhor Presidente,

solicitação para que sejam feito estudos técnicos que possam atender a demanda dos usuários da UBS do Bairro Nossa Senhora das Graças.

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 143, NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, 38.402-008,
UBERLÂNDIA - MG

- JUSTIFICATIVA -


Existe um equipamento na Unidade de Saúde supracitada, que atende ao setor de assistência dentária (compressor de ar) e que funciona com ruído excessivo, inclusive tendo esta situação sido avaliada por equipe técnica do Trabalho, que constatou que o barulho está acima do limite máximo permitido. Quando foi constatado formalmente o problema, foi feito o compromisso de se solucionar tal situação, o que não aconteceu. Há alguns meses, este equipamento teve um problema técnico e parou de funcionar, o que foi um alívio geral, (apesar de que a população ficou sem atendimento por 3 meses) porém agora retornou e o problema continua. O consultório contíguo é obrigado a atender os pacientes com a janela fechada, mesmo nos dias de intenso calor, mas mesmo assim o barulho incomoda e coloca em risco a saúde dos trabalhadores da Unidade. Considerando ser esta uma situação inaceitável, em especial por se tratar de um estabelecimento assistencial de saúde e que este problema está afetando a saúde e qualidade de vida dos servidores do município e também dos cidadãos, vimos solicitar providências urgentes para que seja apontada uma solução adequada.

De acordo com o art. 233, da Resolução nº 031/02, REQUEREMOS a Vossa Excelência que seja encaminhado à SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Sala das Sessões, 4 de junho de 2019



CARRIJO
PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

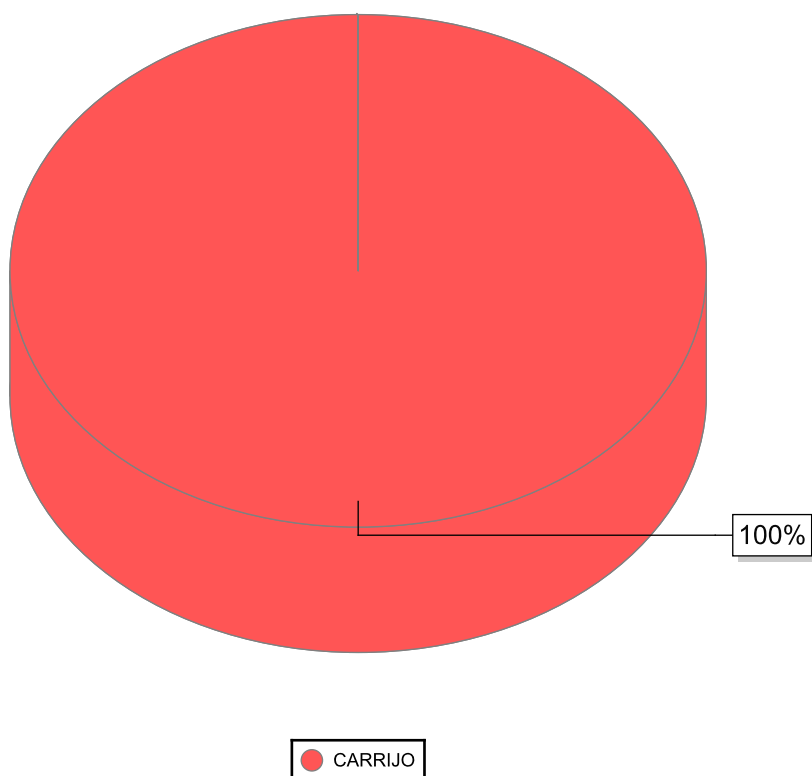

Nome	Quantidade
CARRIJO	1
Total	1